BD SENSORS
pressure measurement

WEITERFÜHRENDE ANGABEN ZUR PARAMETRISIERUNG DES DRUCKSCHALTERS

Sehr geehrter Kunde,
bitte füllen Sie diesen Fragebogen aus, und senden uns diesen sofort nach Ihrer Bestellung an folgende Fax-Nr. +49 (0) 9235 / 98 11-11. Falls keine näheren Angaben gemacht werden, wird der Druckschalter gemäß BD SENSORS Standard (Schaltmodus A, Schaltausgänge aktiv, Einschaltpunkt bei 80 % und Rückschaltpunkt bei 75 %, Ein- u. Ausschaltverzögerung ausgeschaltet) eingestellt.

Firma: .....

Bestellnummer: ..... Bestellposition: .....

Bitte notieren Sie hier den Typ und den Bestellschlüssel des Geräts:

Seriennummer: ..... (Wird von BD SENSORS ausgefüllt!)

Schaltmodi

A Hysteresemodus

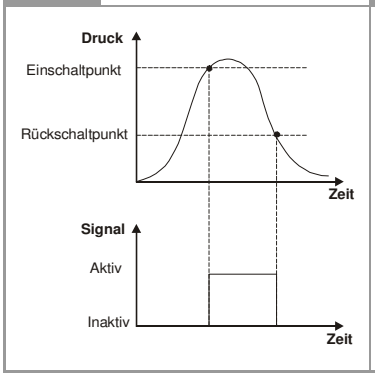

B Hysteresemodus invertiert

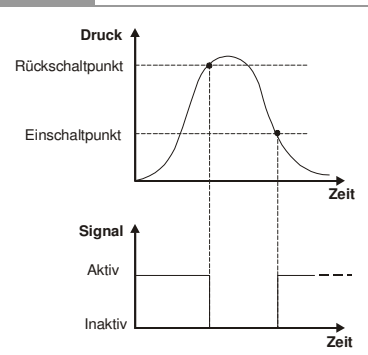

C Fenstermodus

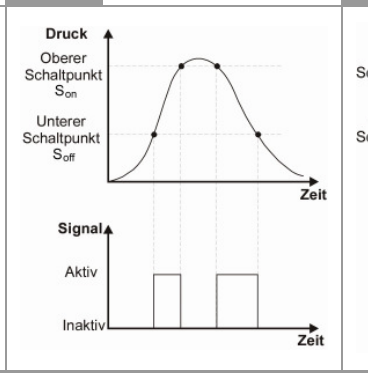

D Fenstermodus invertiert

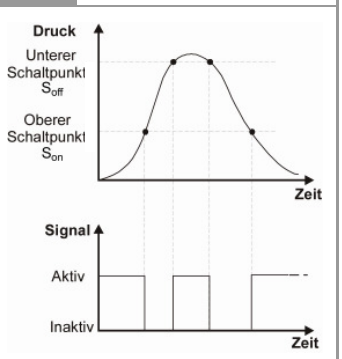

Parameter	Schaltausgang 1	Schaltausgang 2
Schaltmodus:	☐ **A** oder ☐ **B** oder ☐ **C** oder ☐ **D**	☐ **A** oder ☐ **B** oder ☐ **C** oder ☐ **D**
Einschaltpunkt/ Unterer Schaltpunkt [1]:	..... %	..... % .....
Rückschaltpunkt/ Oberer Schaltpunkt [1]:	..... %	..... % .....
Einschaltverzögerung:	..... ms	..... ms
Ausschaltverzögerung:	..... ms	..... ms

[1] in % d. Spanne oder in physikalischer Einheit

..... Datum und Unterschrift: .....

BD SENSORS Auftragsnummer

BD SENSORS GmbH
BD-Sensors-Straße 1
D - 95199 Thierstein
Telefon +49 (0) 92 35 / 98 11- 0
Telefax +49 (0) 92 35 / 98 11- 11
www.bdsensors.de
info@bdsensors.de